

Apakah yang ada pada risalah ini

1. Apakah kegunaan NovoEight®
2. Bagaimana NovoEight® berfungsi
3. Sebelum menggunakan NovoEight®
4. Cara menggunakan NovoEight®
5. Semasa menggunakan NovoEight®
6. Kesan-kesan sampingan
7. Cara penyimpanan dan pelupusan NovoEight®
8. Maklumat lanjut
9. Pengilang
10. Pemegang Pendaftaran Produk
11. Tarikh kemaskini RiMUP

1. Apakah kegunaan NovoEight®

NovoEight® digunakan untuk merawat dan mencegah kejadian pendarahan di kalangan pesakit yang menghadapi hemofilia A (kekurangan faktor VIII secara semula jadi) dan boleh digunakan oleh semua kumpulan umur.

2. Bagaimana NovoEight® berfungsi

NovoEight® mengandungi bahan aktif *turoctocog alfa*, faktor koagulasi manusia VIII. Faktor VIII ialah protein yang terjumpa secara semula jadi di dalam darah yang membantunya untuk membeku.

Di kalangan pesakit yang menghadapi hemofilia A, faktor VIII tiada atau tidak berfungsi dengan betul. NovoEight® menggantikan 'faktor VIII' yang tidak berfungsi atau tiada dan membantu darah membentuk bekuan pada tempat pendarahan.

3. Sebelum menggunakan NovoEight®

- Bila tidak boleh menggunakan NovoEight®

- Jika anda alergic terhadap bahan aktif atau mana-mana bahan lain ubat ini.
- Jika anda alergic terhadap protein hamster.

Jangan guna NovoEight® jika mana-mana satu kenyataan di atas berkenaan dengan anda. Jika anda tidak pasti, bincang dengan doktor anda sebelum menggunakan ubat ini.

- Sebelum mula menggunakan NovoEight®

Bincang dengan doktor anda sebelum menggunakan NovoEight®.

- Jika menggunakan ubat-ubat lain

Maklumkan doktor anda jika anda menggunakan, baru-baru ini menggunakan atau mungkin akan menggunakan ubat-ubat lain.

4. Cara menggunakan NovoEight®

- Berapa banyak harus digunakan

Rawatan dengan NovoEight® akan dimulakan oleh doktor yang berpengalaman dalam penjagaan pesakit yang menghadapi hemofilia A. Sentiasa guna ubat ini seperti yang dimaklumkan oleh doktor anda. Semak dengan doktor anda jika anda tidak pasti.

Doktor anda akan mengira dos anda untuk anda. Ini akan bergantung kepada berat badan anda dan untuk apa ubat ini digunakan.

Pencegahan pendarahan

Dos yang biasa untuk NovoEight® adalah 20 hingga 50 unit antarabangsa (IU) setiap kg berat badan. Suntikan diberi setiap 2 hingga 3 hari. Dalam sesetengah kes, terutamanya dalam pesakit yang lebih muda, suntikan yang lebih kerap atau dos yang lebih tinggi mungkin diperlukan.

Rawatan pendarahan

Dos NovoEight® dikira bergantung kepada berat badan anda dan paras faktor VIII yang ingin dicapai. Sasaran paras faktor VIII akan bergantung kepada ketenatan dan lokasi pendarahan.

Penggunaan di kalangan kanak-kanak dan remaja

NovoEight® boleh digunakan oleh semua umur kanak-kanak. Untuk kanak-kanak (di bawah umur 12 tahun) dos yang lebih tinggi atau suntikan yang lebih kerap mungkin diperlukan. Remaja (di atas umur 12 tahun) boleh menggunakan dos yang sama dengan orang dewasa.

Bagaimana NovoEight® diberikan

NovoEight® diberikan secara suntikan ke dalam saluran darah. Lihat 'Arahan penggunaan NovoEight®' untuk maklumat lanjut.

- Bila perlu digunakan

Guna ubat ini seperti yang dimaklumkan oleh doktor anda.

- Berapa lama perlu digunakan

Jika anda berhenti menggunakan NovoEight® anda mungkin tidak lagi dilindungi daripada pendarahan atau pendarahan semasa mungkin tidak akan berhenti. Jangan berhenti menggunakan NovoEight® tanpa berbincang dengan doktor anda.

Jika anda mempunyai soalan-soalan lanjut tentang penggunaan ubat ini, tanya doktor anda.

- Jika terlupa menggunakan

Anda harus memaklumkan doktor anda jika anda terlepas satu dos dan tidak tahu bagaimana untuk menggantikannya.

- Jika menggunakan berlebihan (terlebih dos)

Jika anda menggunakan lebih NovoEight® daripada apa yang anda patut, maklumkan doktor anda atau pergi ke hospital dengan segera.

5. Semasa menggunakan NovoEight®

- Perkara yang perlu dilakukan

Terdapat kemungkinan jarang anda boleh mengalami tindak balas anafilaksis (satu tindak balas alergi yang teruk dan berlaku secara tiba-

tiba) terhadap NovoEight®. Tanda-tanda awal tindak balas alergi adalah ruam, *hives*, *weals*, kegatalan umum, bengkak pada bibir dan lidah, kesukaran bernafas, berdehit, sesak dada, rasa tidak sihat secara umum, dan pening.

Jika sebarang gejala ini berlaku, hentikan suntikan serta merta dan hubungi doktor anda.

Bincang dengan doktor anda jika anda berasa bahawa pendarahan anda tidak terkawal dengan dos yang anda menerima, kerana terdapat beberapa sebab kejadian ini. Seseorang orang yang menggunakan ubat ini boleh menghasilkan antibodi terhadap faktor VIII (juga dikenali sebagai perencat faktor VIII). Perencat faktor VIII menyebabkan NovoEight® kurang berkesan dalam mencegah atau mengawal pendarahan. Jika ini berlaku anda mungkin memerlukan dos NovoEight® yang lebih tinggi atau jenis ubat yang lain untuk mengawal pendarahan anda. Jangan menambah jumlah dos NovoEight® anda tanpa berbincang dengan doktor anda. Anda harus memberitahu doktor anda jika anda pernah dirawat dengan produk-produk faktor VIII, terutamanya jika anda menghasilkan perencat, kerana mungkin terdapat risiko yang lebih tinggi ia akan berlaku lagi.

Pembentukan perencat (antibodi) adalah komplikasi yang diketahui yang boleh berlaku semasa rawatan dengan semua ubat Faktor VIII. Perencat ini, terutamanya pada paras yang tinggi, menghentikan rawatan yang berfungsi dengan betul dan anda atau anak anda akan dipantau dengan teliti untuk pembangunan perencat ini. Jika anda atau pendarahan anak anda tidak dikawal dengan NovoEight®, beritahu doktor anda dengan serta-merta.

- Perkara yang tidak boleh dilakukan

Jangan berhenti menggunakan NovoEight® tanpa berbincang dengan doktor anda.

- Perkara yang perlu diberi perhatian

Kehamilan dan penyusuan bayi

Jika anda hamil atau sedang menyusukan bayi, berasa bahawa anda mungkin hamil atau sedang merancang untuk hamil, minta doktor anda untuk nasihat sebelum menggunakan ubat ini.

Memandu dan menggunakan mesin

NovoEight® tidak mempunyai pengaruh ke atas kemampuan anda untuk memandu atau menggunakan mesin.

NovoEight® mengandungi natrium

Ubat ini mengandungi 30.5 mg natrium (kandungan utama dalam garam untuk memasak/makan) dalam setiap vial selepas ubat telah dilarutkan.

Ini bersamaan dengan 1.5% daripada jumlah maksimum pengambilan natrium dalam diet yang disyorkan untuk orang dewasa. Sila berbincang dengan doktor anda jika anda mengambil diet natrium terkawal.

6. Kesan-kesan sampingan

Seperti semua ubat, ubat ini boleh menyebabkan kesan sampingan, walaupun bukan semua orang mengalaminya. Kesan-kesan sampingan yang berikut mungkin berlaku dengan ubat ini.

Jika tindak balas alergi yang teruk dan mendadak (tindak balas anafilaksis) berlaku (sangat jarang), suntikan harus dihentikan segera. Anda mesti menghubungi doktor anda segera jika anda mengalami satu daripada gejala awal berikut:

- ▶ Kesukaran bernafas, sesak nafas atau berdehit
- ▶ Sesak dada
- ▶ Bengkak pada bibir dan lidah
- ▶ Ruam, *hives*, *weals* atau kegatalan umum

▶ Berasa pening atau kehilangan kesedaran

▶ Tekanan darah rendah (mempunyai kulit yang pucat dan sejuk, denyutan jantung yang pantas)

Gejala-gejala yang teruk, termasuk kesukaran menelan atau bernafas dan muka atau tangan yang merah atau bengkak, memerlukan rawatan kecemasan segera. Jika anda mempunyai tindak balas alergi, doktor anda mungkin menukarkan ubat anda.

Bagi kanak-kanak yang tidak pernah dirawat dengan ubat Faktor VIII, antibodi perencat (rujuk bahagian 5. Semasa menggunakan NovoEight®) mungkin terbentuk dengan lazim (lebih daripada 1 dalam 10 pesakit); walau bagaimanapun bagi pesakit yang telah menerima rawatan sebelumnya dengan Faktor VIII (lebih daripada 150 hari rawatan) risiko ini adalah jarang (kurang daripada 1 dalam 100 pesakit). Jika ini berlaku kepada anda atau ubat-ubatan anak anda mungkin berhenti berfungsi dengan baik dan anda atau anak anda mungkin mengalami pendarahan yang berterusan. Sekiranya ini berlaku, anda perlu segera menghubungi doktor anda.

Kesan-kesan sampingan biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang)

- ▶ Ujian darah menunjukkan perubahan cara hati berfungsi
- ▶ Tindak balas (kemerahan dan kegatalan) di sekitar tempat anda menyuntik ubat

Kesan-kesan sampingan biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 10 orang) bagi pesakit yang belum pernah dirawat dengan ubat Faktor VIII

- ▶ Kemerahan kulit
- ▶ Keradangan vena
- ▶ Pendarahan ke dalam sendi
- ▶ Pendarahan ke dalam tisu otot
- ▶ Batuk
- ▶ Kemerahan di sekitar tapak suntikan kateter

► Muntah

Kesan-kesan sampingan yang tidak biasa (boleh menjejaskan sehingga 1 dalam 100 orang)

- Berasa letih
- Sakit kepala
- Berasa pening
- Kesukaran tidur (*insomnia*)
- Denyutan jantung yang pantas
- Peningkatan tekanan darah
- Ruam
- Demam
- Berasa panas
- Kekejangan otot
- Kesakitan otot
- Kesakitan kaki dan lengan tangan
- Bengkak kaki dan tapak kaki
- Penyakit sendi
- Lebam
- Sakit jantung

Kesan-kesan sampingan di kalangan kanak-kanak dan remaja

Kesan-kesan sampingan yang diperhatikan di kalangan kanak-kanak dan remaja adalah sama seperti yang diperhatikan di kalangan orang dewasa.

Melaporkan kesan-kesan sampingan

Jika anda mengalami kesan sampingan, sila beritahu doktor, ahli farmasi atau jururawat anda. Ini termasuk apa-apa kesan sampingan yang tidak disenaraikan dalam risalah ini.

Anda boleh melaporkan sebarang kesan sampingan atau kesan advers ubat kepada Pusat Pemantauan Kesan Advers Ubat Kebangsaan melalui laman web npra.gov.my [*Consumers → Reporting Side Effects to Medicines (ConSERF) or Vaccines (AEFI)*]

7. Cara penyimpanan dan pelupusan NovoEight®

- Penyimpanan

Jauhkan ubat ini daripada penglihatan dan capaian kanak-kanak.

Jangan gunakan ubat ini selepas tarikh luput, yang ternyata selepas 'Expiry' pada kotak dan pada label vial dan picagari pra-isi. Tarikh luput merujuk kepada hari terakhir bulan tersebut.

Simpan di dalam peti sejuk (2°C – 8°C).

Jangan bekukan.

Simpan vial di dalam kotak karton untuk melindungi ubat daripada cahaya.

Sebelum serbuk NovoEight® dilarutkan ia boleh disimpan pada:

- Suhu bilik ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) untuk tempoh tidak melebihi 9 bulan
- atau**
- Atas suhu bilik (30°C sehingga 40°C) untuk tempoh tidak melebihi 3 bulan)

Sebaik sahaja produk telah dikeluarkan dari peti sejuk, produk itu tidak boleh disimpan semula ke dalam peti sejuk.

Sila catatkan permulaan penyimpanan produk dan suhu penyimpanan pada kotak produk.

Selepas anda telah melarutkan NovoEight® ia harus digunakan dengan serta merta. Jika anda tidak boleh guna larutan NovoEight® yang dilarutkan dengan segera, ia harus digunakan dalam masa:

- 24 jam apabila disimpan pada suhu 2°C – 8°C
- 4 jam apabila disimpan pada suhu 30°C, bagi produk yang telah disimpan pada suhu bilik ($\leq 30^{\circ}\text{C}$) untuk tempoh tidak melebihi 9 bulan
- 4 jam apabila disimpan pada suhu sehingga 40°C, bagi produk yang telah disimpan pada suhu melebihi suhu bilik (30°C sehingga 40°C) untuk tempoh tidak melebihi 3 bulan.

Simpankan produk yang dilarutkan di dalam vial. Jika tidak digunakan dengan segera, ubat ini mungkin tidak akan steril lagi dan boleh menyebabkan jangkitan. Jangan simpan larutan tanpa nasihat doktor anda.

Serbuk di dalam vial kelihatan sebagai serbuk yang putih atau kuning sedikit. Jangan gunakan serbuk jika warna telah berubah.

Larutan NovoEight® adalah jernih hingga berwarna pucat (*opalescent*). Jangan guna ubat ini jika anda perhatikan ia keruh atau mengandungi tompok yang boleh dilihat.

- Pelupusan

Jangan buang sebarang ubat-ubatan melalui air kumbahan atau bahan buangan rumah. Tanya ahli farmasi anda bagaimana untuk buang ubat-ubatan yang anda tidak lagi guna. Langkah-langkah ini akan membantu melindungi pesakit.

8. Maklumat lanjut

- Rupa and warna produk

NovoEight® terdiri daripada serbuk dan pelarut untuk membentuk larutan untuk suntikan.

Setiap pek NovoEight® mengandungi satu vial dengan serbuk putih atau kuning sedikit, satu picagari pra-isi 4 ml dengan larutan yang jernih dan tidak berwarna, pelocok dan vial penyesuai.

- Bahan-bahan kandungan

- Bahan aktif

Turoctocog alfa (faktor koagulasi manusia VIII (rDNA)). Setiap vial NovoEight® mengandungi secara nominal 250, 500 atau 1000 IU *turoctocog alfa*.

- Bahan tidak aktif

L-histidine, sukrosa, *polysorbate 80*, natrium klorida, *L-methionine*, *calcium chloride dihydrate*, natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Bahan kandungan di dalam pelarut adalah natrium klorida dan air untuk suntikan.

Selepas serbuk NovoEight® dilarut dengan pelarut yang dibekalkan (larutan natrium klorida 9 mg/ml (0.9%) untuk suntikan), larutan yang disediakan untuk suntikan masing-masing mengandungi 62.5, 125 atau 250 IU *turoctocog alfa* setiap ml (berdasarkan kekuatan *turoctocog alfa*, iaitu 250, 500 atau 1000 IU).

- Nombor MAL

250IU: MAL16085031AZ

500IU: MAL16085029AZ

1000IU: MAL16085030AZ

9. Pengilang

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Denmark

10. Pemegang Pendaftaran Produk

Novo Nordisk Pharma (Malaysia)
Sdn. Bhd.
Menara 1 Sentrum, Level 16
No. 201 Jalan Tun Sambanthan
50470 Kuala Lumpur
Malaysia

11. Tarikh kemaskini RiMUP

25 Mei 2021

Nombor Siri

NPRA(R3/01)22042021/0128

ARAHAN PENGGUNAAN NOVOEIGHT®

BACA ARAHAN-ARAHAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNA NOVOEIGHT®.

NovoEight® dibekalkan sebagai serbuk. Sebelum suntikan (penggunaan ubat) ia mesti dilarut dengan pelarut yang dibekalkan di dalam picagari. Pelarut ini ialah larutan natrium klorida 9 mg/ml (0.9%). NovoEight® yang dilarutkan mesti disuntik ke dalam vena anda (suntikan *intravenous*). Peralatan dalam bungkusan ini direka untuk melarut dan menyuntik NovoEight®.

Anda juga memerlukan satu set infusi (tiub dan jarum rama-rama), kapas beralkohol steril, pad kasa dan plaster. Peralatan ini tidak termasuk di dalam bungkusan NovoEight®.

Jangan menggunakan peralatan ini tanpa latihan yang betul daripada doktor atau jururawat anda.

Sentiasa basuh tangan anda dan pastikan bahawa tempat di sekitar anda adalah bersih.

Apabila anda menyedia dan menyuntik ubat-ubatan terus ke dalam vena, ia adalah penting untuk menggunakan teknik yang bersih dan bebas kuman (*aseptic*). Teknik yang tidak betul boleh membawakan kuman yang boleh menjangkitkan darah.

Jangan buka peralatan sehingga anda sedia untuk menggunakannya.

Jangan guna peralatan jika ia telah jatuh, atau jika ia telah rosak. Sebaliknya, gunakan bungkusan yang baru.

Jangan guna peralatan ini jika ia telah tamat tempoh. Sebaliknya, gunakan bungkusan yang baru. Tarikh luput ternyata selepas 'Expiry' pada kotak, pada vial, pada

vial penyesuai, dan pada picagari pra-isi.

Jangan guna peralatan ini jika anda mengesyaki ia telah tercemar. Sebaliknya, gunakan bungkusan yang baru.

Jangan buang mana-mana alat sehingga anda telah menyuntik larutan NovoEight®.

Peralatan ini adalah untuk kegunaan satu kali sahaja.

Kandungan

Bungkusan ini mengandungi:


- 1 vial dengan serbuk NovoEight®
- 1 vial penyesuai
- 1 picagari pra-isi dengan pelarut
- 1 pelocok (ditempatkan di bawah picagari)

Ringkasan


Vial dengan serbuk NovoEight®




Vial penyesuai

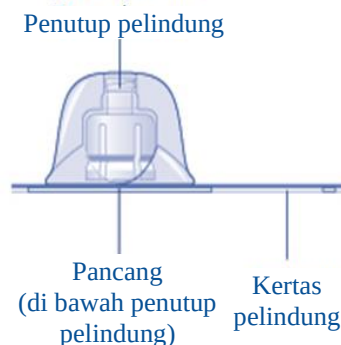

Picagari pra-isi dengan pelarut

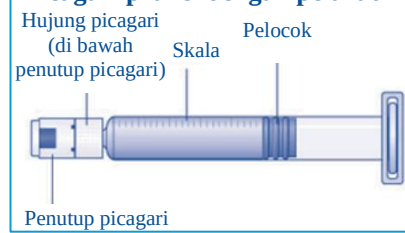

Pelocok

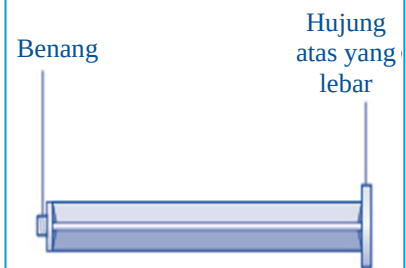

1. Sediakan vial dan picagari

► Keluarkan jumlah bungkusan NovoEight® yang anda perlukan.

► Semakkan tarikh luput.


► Semakkan nama, kekuatan ubat dan warna bungkusan, untuk memastikan ia mengandungi produk yang betul.

► Basuhkan tangan anda dan keringkan dengan baik dengan menggunakan tuala yang bersih atau menggunakan udara.

► Keluarkan vial, vial penyesuai dan picagari pra-isi daripada kotak. **Biarkan pelocok tidak tersentuh di dalam kotak.**

► Bawakan suhu vial dan picagari pra-isi ke suhu bilik. Anda boleh membuat demikian dengan memegangnya di dalam tangan anda sehingga berasa pada suhu yang sama dengan tangan anda.


► **Jangan gunakan sebarang cara lain untuk memanaskan vial dan picagari pra-isi.**

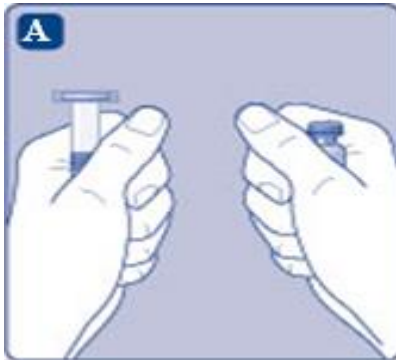

► **Tanggalkan penutup plastik** daripada vial. **Jika penutup plastik longgar atau hilang, jangan gunakan vial tersebut.**

► **Sapukan penyumbat getah** dengan kapas beralkohol steril dan biarkannya kering dalam udara selama beberapa saat sebelum diguna untuk memastikan ia bebas kuman sebaik mungkin.

► **Jangan sentuh penyumbat getah** dengan jari-jari anda kerana ini boleh memindahkan kuman.

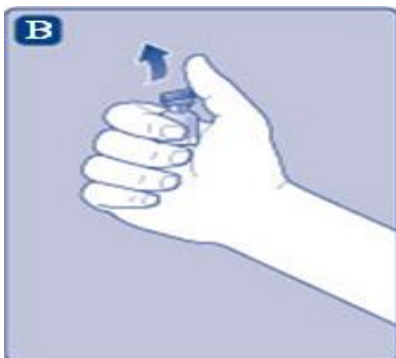

2. Pasangkan vial penyesuai

► **Tanggalkan kertas pelindung** daripada vial penyesuai.

Jika kertas pelindung tidak dilekat sepenuhnya atau jika ia telah rosak, jangan gunakan vial penyesuai.

Jangan keluarkan vial penyesuai daripada penutup pelindung dengan jari-jari anda.

Jika anda tersentuh pancang pada vial penyesuai, kuman dari jari anda boleh dipindahkan.



► **Letakkan vial atas permukaan yang rata dan kukuh.**

► **Terbalikkan penutup pelindung** dan pasang vial penyesuai pada vial.

Setelah dipasangkan, jangan tanggalkan vial penyesuai dari vial.



► **Picitkan penutup pelindung** secara lembut dengan ibu jari dan jari telunjuk anda seperti yang ditunjuk.

Tanggalkan penutup pelindung dari vial penyesuai.


Jangan terangkat vial penyesuai dari vial apabila mengeluarkan penutup pelindung.



3. Pasangkan pelocok dan picagari

► **Genggam pelocok** pada hujung atas yang lebar dan keluarkannya dari kotak. **Jangan sentuh tepi-tepi atau benang pelocok.** Jika anda menyentuh tepi-tepi atau benangnya, kuman dari jari-jari anda boleh dipindahkan.

► **Segera** sambungkan pelocok ke picagari dengan memutarkannya mengikut arah jam ke dalam pelocok di dalam picagari pra-isi sehingga rintangan dirasa.

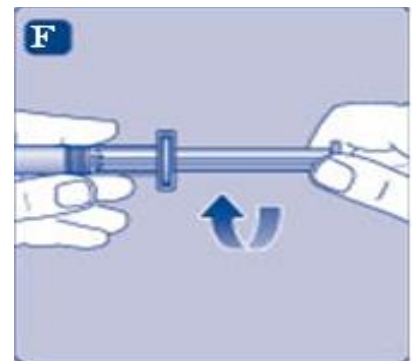


► **Tanggalkan penutup picagari** daripada picagari pra-isi dengan membengkoknya ke bawah sehingga tebukannya putus.

► **Jangan sentuh hujung picagari yang berada di bawah penutup picagari.** Jika anda tersentuh hujung picagari, kuman dari jari-jari anda boleh dipindahkan.

Jika penutup picagari longgar atau hilang, jangan gunakan picagari pra-isi ini.



► **Putarkan picagari pra-isi secara rapat** pada vial penyesuaian sehingga rintangan dirasa.

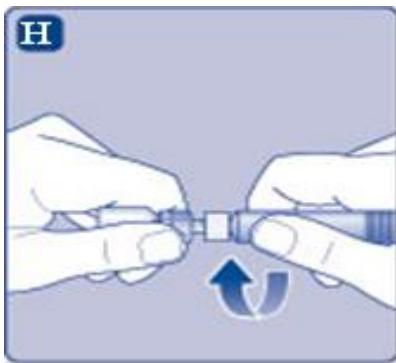

4. Larutkan serbuk dengan pelarut

► **Pegang picagari pra-isi secara condong sedikit** dengan vial mengarah ke bawah.

► **Tolak pelocok** untuk menyuntik semua pelarut ke dalam vial.



► **Dengan pelocok masih ditekan ke bawah**, pusarkan vial dengan

lembut sehingga semua serbuk terlarut.

Jangan gocangkan vial kerana ini akan menyebabkannya berbuih.

► **Semak larutan yang dilarutkan.** Ia mesti kelihatan jernih hingga berwarna pucat (sedikit tidak jernih). **Jika anda perhatikan tompok yang boleh dilihat atau penyahwarnaan, jangan menggunakannya.** Sebaliknya, gunakan bungkus yang baru.



NovoEight® disyorkan untuk digunakan segera selepas ia telah dilarutkan. Ini adalah kerana jika ia dibiarkan, ubat ini mungkin menjadi tidak steril dan boleh menyebabkan jangkitan.

Jika anda tidak boleh menggunakan larutan NovoEight® dengan segera, ia harus digunakan dalam masa 4 jam apabila disimpan pada suhu bilik atau sehingga 40°C dan dalam masa 24 jam apabila disimpan pada 2°C – 8°C. Simpankan produk yang dilarutkan di dalam vial.

Jangan bekukan larutan NovoEight® atau simpankannya di dalam picagari.

Jangan simpan larutan NovoEight® tanpa nasihat doktor anda.

Jauhkan larutan NovoEight® daripada sinaran cahaya.



Jika dos anda memerlukan lebih daripada satu vial, ulangkan langkah A hingga J dengan vial, vial penyesuaian dan picagari pra-isi tambahan sehingga anda telah mencapai dos yang anda perlukan.

► **Biarkan pelocok ditolak ke dalam dengan sepenuhnya.**

► **Terbalikkan picagari** dengan vial.

► **Berhenti menolak pelocok dan biarkannya bergerak kembali** dengan sendiri semasa larutan NovoEight® mengisi masuk picagari.

► **Tarikkan pelocok ke bawah sedikit** untuk menarik larutan NovoEight® ke dalam picagari.

► **Sekiranya anda hanya memerlukan sebahagian daripada seluruh vial**, gunakan skala pada picagari untuk melihat berapa banyak larutan yang anda keluarkan, seperti yang diarahkan oleh doktor atau jururawat anda.

Jika, pada bila-bila masa, terdapat terlalu banyak udara di dalam picagari, suntikkan udara kembali ke dalam vial.


► **Semasa memegang vial dengan terbalik**, **ketukkan picagari secara lembut** untuk membolehkan sebarang buih udara naik ke atas.

► **Tolak pelocok** dengan perlahan-lahan sehingga semua buih udara hilang.



► **Longgarkan vial penyesuai** dengan vial.

► **Jangan sentuh hujung picagari.** Jika anda menyentuh hujung picagari, kuman dari jari-jari anda boleh dipindahkan.

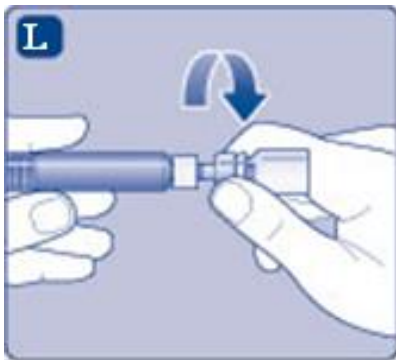

5. Suntik larutan NovoEight®

Sekarang, NovoEight® sedia untuk disuntik ke dalam vena anda.

► Suntikkan larutan NovoEight® seperti yang diarah oleh doktor atau jururawat anda.

► Suntik secara perlahan-lahan selama 2 hingga 5 minit.

► Jangan campur NovoEight® dengan sebarang infusi ke dalam vena (*intravenous*) atau ubat-ubatan lain.

Menyuntik NovoEight® melalui *needleless connector* untuk kateter intravena (IV)

Amaran: Picagari pra-isi diperbuat daripada kaca dan direka bentuk untuk digunakan bersama *luer-lock connector* yang standard. Sesetengah *needleless connector* dengan lonjakan dalaman adalah tidak sesuai untuk digunakan bersama picagari pra-isi ini. Ketidaksesuaian ini mungkin menghalang penggunaan ubat-ubatan dan/atau menyebabkan kerosakan kepada *needleless connector*.

Menyuntik larutan ubat melalui peranti akses vena pusat (CVAD) seperti kateter vena pusat atau port bawah kulit (*subcutaneous port*):

► Gunakan teknik yang bersih dan bebas kuman (*aseptic*). Ikuti arahan untuk cara penggunaan *needleless connector* dan CVAD yang betul dengan berunding dengan doktor atau jururawat anda.

► Picagari 10 ml yang steril mungkin diperlukan untuk mengeluarkan larutan ubat untuk penyuntikan ke dalam CVAD. Langkah ini harus dilakukan sejurus selepas langkah J.

► Jika salur CVAD harus dibilas sebelum atau selepas suntikan NovoEight®, gunakan larutan natrium klorida 9 mg/ml untuk suntikan.

Pelupusan

► **Selepas suntikan, buang dengan selamat** semua larutan NovoEight® yang tidak diguna, picagari dengan set infusi, vial dengan vial penyesuai dan bahan buangan lain seperti yang diarahkan oleh ahli farmasi anda.

Jangan buangnya dengan bahan buangan biasa rumah.



Jangan membuka peralatan sebelum ingin membuangnya.

Jangan guna semula peralatan.